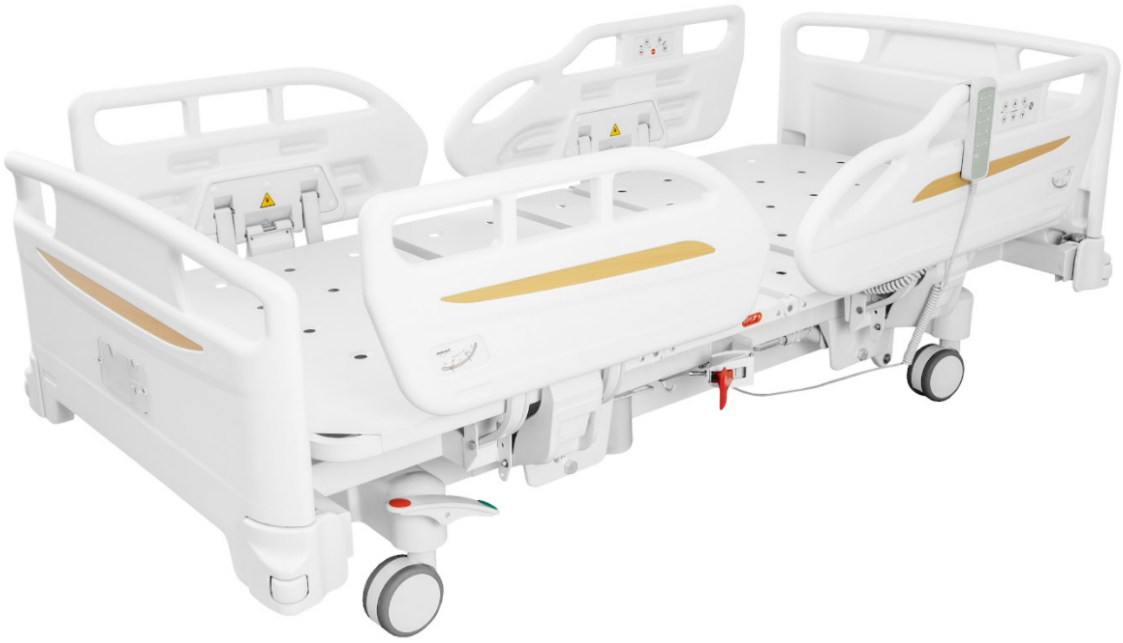

Łóżko regulowane elektrycznie Integra (DA-3 C5)

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

Łóżko regulowane elektrycznie z dzielonymi barierkami

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie	TAK
2	Maksymalna długość całkowita łóżka	2110mm
3	Maksymalna szerokość całkowita łóżka	990mm
4	Wymiary leża	1885x900mm
5	Dopuszczalne obciążenie robocze	170kg
6	Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych: - zmiana wysokości leża - regulacja kąta uniesienia segmentu pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu ud	TAK
7	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli.	TAK
8	Szczyty łóżka tworzywowe, zaokrąglone z dwóch stron w kierunku leża	TAK
9	Czterosegmentowe leże wypełnione metalowymi panelami. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Segmenty leża zaokrąglone.	TAK
10	Zakres wysokości	500-760 mm
11	Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców	75°
12	Kąt uniesienia segmentu oparcia nóg	35°

13	Minimalna wysokość leża	500mm
14	Sterowanie łóżka za pomocą pilota przewodowego	TAK
15	Barierki boczne podwójnie dzielone, tworzywowe, po obu stronach łóżka, chroniące pacjenta na całej długości leża.	TAK
16	Wymiary barierek w segmencie głowy	940x340mm
17	Wymiary barierek w segmencie nóg	770x340mm
18	Barierki w segmencie głowy z wbudowanym (nie naklejanym) wskaźnikiem kąta pochylenia segmentu pleców	TAK
19	Barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm spowolnionego opuszczania za pomocą sprężyny gazowej. Zatrzaśnięcie barierek wyraźnie sygnalizowane kliknięciem. Zwalnianie barierek za pomocą jednej ręki.	TAK
20	Podwójne koła o średnicy	125mm
21	Odbojniki kołowe o średnicy 50mm umieszczone w każdym narożniku łóżka wychodzących poza obrys ramy i szczytu łóżka	TAK
22	Uchwyty na worki urologiczne, uchwyty na wieszak kroplówki, uchwyty na wysięgnik ręki	TAK
23	Szczyty łóżka i inne elementy tworzywowe umożliwiające sterylizację w warunkach do 120°C, pod ciśnieniem do 30MPa	TAK
24	Łóżko wyposażone w ciche siłowniki liniowe pracujące na poziomie głośności	do 50dB
25	Przycisk STOP awaryjnie zatrzymujący wszystkie aktualnie wykonywane funkcje	TAK
26	Dołączony stojak kroplówki	TAK
27	Blokada kierunkowa i hamulec umieszczone nad kołami od strony nóg pacjenta (oznaczone kolorystycznie: kolor zielony blokada kierunkowa, kolor czerwony hamulec)	TAK
	Dodatkowe wyposażenie (dostępne za dopłatą)	
1	Elektryczna regulacja przechyłów wzdłużnych (tb/atb)	12°
2	Łóżko wyposażone w mechaniczny CPR segmentu pleców	TAK
3	Panel sterowania wbudowany w barierki boczne	TAK
4	Panel pielęgniarski z możliwością powieszenia na szczycie łóżka bądź barierce, umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami łóżka, wyposażony w osobną blokadę dla każdej funkcji	TAK
5	Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego	TAK